

一部出荷期間の修理対応終了のお知らせ

機械器具 74 医薬品注入器

歯科麻酔用電動注射筒

オーラスター® 1.0S

オーラスター® 1.8S

(管理医療機器/特定保守管理医療機器)

2024年2月



株式会社ジーシー昭和薬品
東京都板橋区蓮沼町76番1号

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記製品につきまして、2007年2月～2017年9月初旬まで弊社より出荷いたしました機種(前期型)の本体メイン基板や受口などの部品の生産・供給が終了となりましたため、2024年9月末日の弊社受付分をもちまして修理を終了させていただきます。

なお、2017年9月中旬以降に弊社より出荷しております機種(後期型)は、仕様を変更して販売を継続しておりますので、修理・点検については引き続き対応をさせていただきます。

前期型および後期型の機種の判別は以下となりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。


甚だ勝手ではございますが、何卒事情をご賢察賜りますよう謹んでご案内申し上げます。

謹白

記

前期型および後期型の機種の判別方法

■下図のフロントカバーの形状(幅)でのみ判別

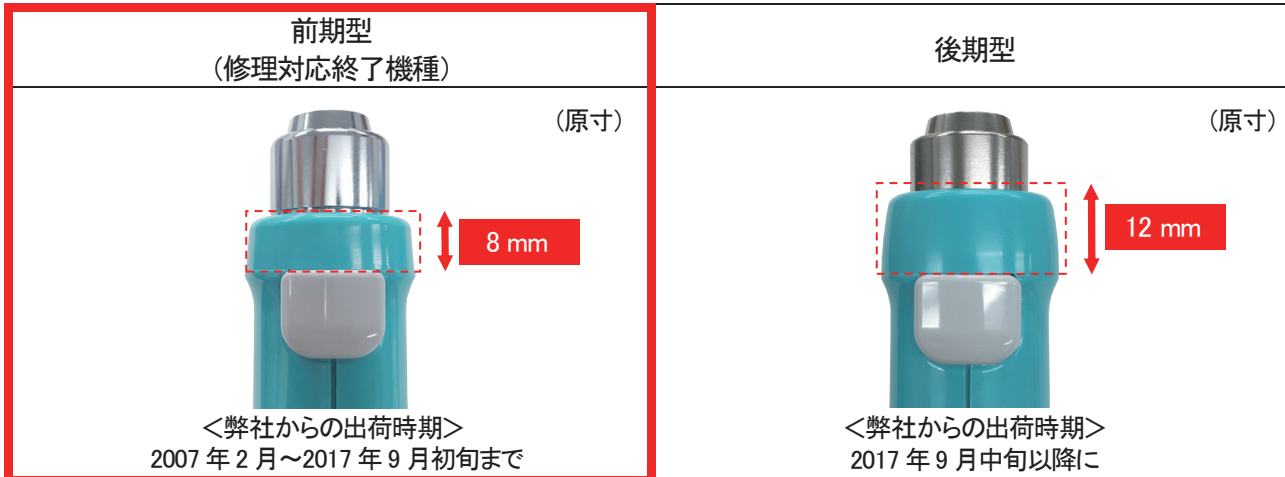

※オーラスター1.0ST、1.8STのフロントカバーの形状は後期型と同様です。

前期型の修理対応終了時期

2024年9月末日

※2007年2月～2017年9月初旬まで弊社より出荷いたしました機種が対象

【お問い合わせ先】

株式会社ジーシー昭和薬品

営業部 TEL:03-5689-1579 <受付時間> 9:00～17:30(土・日・祝日・弊社休日を除く)

オーラスター相談窓口 TEL:044-850-2260 <受付時間> 8:30～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

以上